

Prot. 108/15

**Al Direttore dell'UOC Provveditorato
Avv. Gabriella Salibra
SEDE**

Siracusa, 26/06/2015

Oggetto: Chiarimenti per la Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie per la UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Umberto I di Siracusa.

A seguito dei protocolli dalle ditte Burke & Burke Draeger Ultramed e Sirimed, l'Ing. Francesca Abissi e il Dott. Maurilio Carpinteri si sono riuniti per rispondere alle relative richieste di chiarimenti. Si comunica pertanto quanto segue.

1. E' intento dell'Azienda ricercare l'uniformità dell'uso tra le varie macchine di fasce diverse e l'interscambiabilità così come riportato nel capitolato malgrado ciò , allo scopo di consentire la massima partecipazione da parte delle Ditte Fornitrici, non è stato escluso dal bando la possibilità di accettare offerte da consorzi temporanei di imprese.
2. L'analisi del tratto Qt/Qtc è stata ritenuta utile in quanto consente un adeguato monitoraggio cardiologico su pazienti cardiopatici di classe ASA III ASA IV sottoposti a chirurgia maggiore ortopedica e vascolare in elezione E in urgenza.
3. Non è intento dell'Azienda la completa rimozione dei pensili o l'aggancio strutturato delle Workstation ad esse. L'ipotesi tecnica suggerita è la rimozione delle vecchie macchine di anestesia in uno al pianale inferiore con cassetto. La nuova workstation dovrà essere posta in contiguità con il pensile ed adeguata alla connettività prevista dal pensile stesso. Si ribadisce la necessità di effettuare sopralluogo per maggiore chiarezza.
4. Si chiarisce la necessità nelle Apparecchiature di fascia ALTA, della presenza di Vaporizzatore di tipo ELETTRONICO. Quest'ultimo non è stato ritenuto parametro di minima per le Apparecchiature di Fascia Medio Alta.



REG. N. 3156
UNI EN ISO
9001:2000

00144 Roma - via Laurentina n. 456/458 - P.IVA e iscr. R.I. 06915071002

Telefoni: 39.06544081 - Fax 39.0654408214 - R.E.A. n° 998707 - Cap.Soc. € 6.000.000,00 i.v.


5. Per quanto concerne il picco di flusso nelle apparecchiature di Fascia Alta si specifica che non è stato riportato un valore minimo poiché il livello tecnico delle macchine richieste racchiude ovviamente parametri funzionali di eccellenza.
6. Per effettuare il sopralluogo presso i locali del P.O. Umberto I si può contattare il Dott. Maurilio Carpinteri al numero 335 6499595

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.


Direttore UOC Anestesia e Rianimazione

Dott. Maurilio Carpinteri

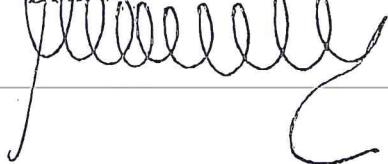

Per Tecnologie Sanitarie

(Ing. Francesca L. Abissi)

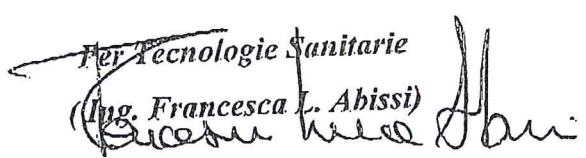

SINGERT



REG. N. 3156
UNI EN ISO
9001:2000

00140 Roma - via Laurentina n. 456/458 - P.IVA e Iscr. R.I. 06915071002
Telefono: 39.06544081 - Fax 39.0654408210 - R.E.A. n° 998707 - Cap.Soc. € 6.000.000,00 i.v.